


お客様各位

平成28年7月

 **デンカ生研株式会社**  
営業本部 国内試薬部門

## ノロウイルス抗原キット

### 『クイックナビ™-ノロ2』部材の色変更等のご案内及び添付文書改訂のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、標記製品につきまして識別性向上の為、一部部材の色変更を行いました。それに伴い、キット添付の操作図、添付文書を改訂致しましたので下記の通りご案内申し上げます。


新旧両製品が流通しご迷惑をおかけ致しますが、今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


#### ■検体浮遊液チューブ及び試料ろ過フィルターの色変更

識別性向上のためチューブの色を白色からピンク色に変更し、試料ろ過フィルターの色を白色からピンク色に変更しました。

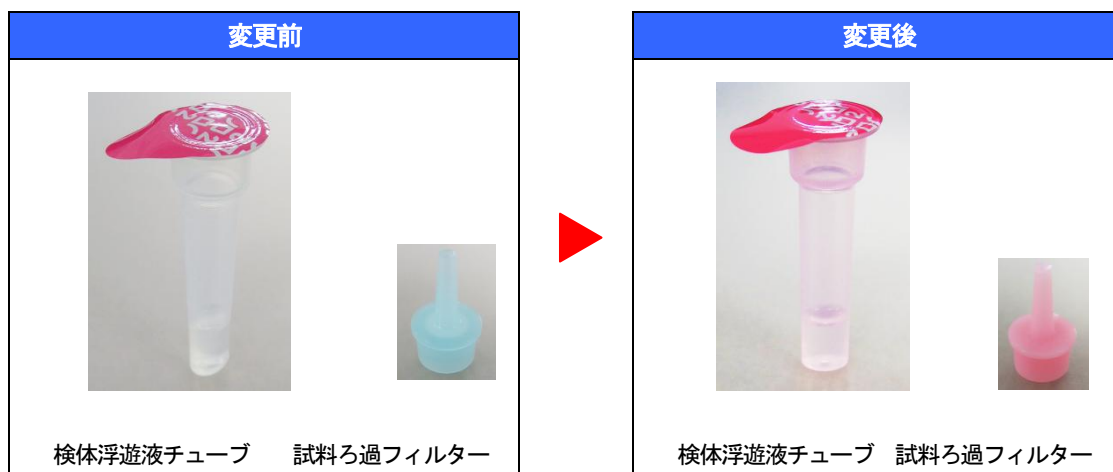

\*印刷物と実際の製品とは色の見え方が少し異なる場合があります。

■キット添付の操作図「操作方法・判定例」の該当箇所の色の変更  
 上記変更に伴い、添付の操作図の該当箇所の色を変更しました。

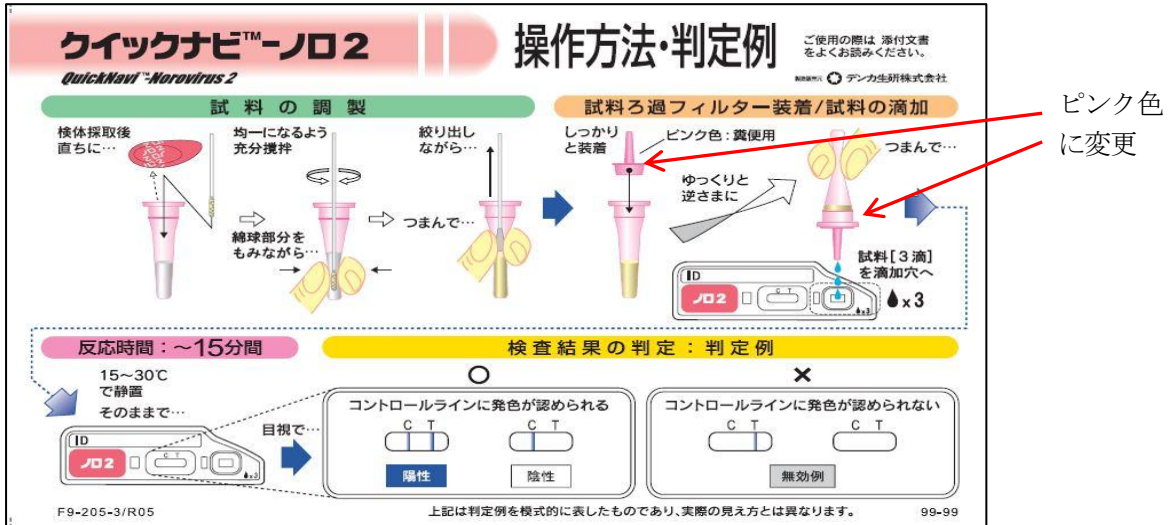

■添付文書改訂

[形状・構造等 (キットの構成)] 改訂内容 一改訂部分のみ抜粋一

改訂後	改訂前
(略) 付属品 ・綿棒 (糞使用) (未滅菌) ・綿棒 (Ex スワブ 003T (輸送チューブ付直腸使用滅菌綿棒)) ・試料ろ過フィルター (糞使用) ※ ・スタンド (紙製; 組み立ててご使用ください。) (以下略)	(略) 付属品 ・綿棒 (糞使用) (未滅菌) ・綿棒 (Ex スワブ 003T (輸送チューブ付直腸使用滅菌綿棒)) ・試料ろ過フィルター (糞使用) ※ [水色] ・スタンド (紙製; 組み立ててご使用ください。) (以下略)

破線部：削除箇所 (試料ろ過フィルターの色変更に伴い記載を整備しました。)

■変更した製品の Lot No. 及び出荷時期

商品番号	商品名	変更 Lot No.	出荷予定時期
324894	クイックナビ™ノロ2 (10回用)	0606081～	2016年8月中旬～

※流通事情により出荷予定時期に若干の差異が生じる場合がありますが、ご了承くださいませようお願い致します。

以上

ご不明な点がございましたら、弊社MR 又は下記までお問い合わせ下さい。

デンカ生研株式会社  
 営業本部 国内試薬部門  
 TEL : 03-6214-3234  
 FAX : 03-6214-3244